

# ORIGINAL ARTICLE

## ***Introducing a new Device to Measure Femoral Canal Length in Reconstructive Surgery of Cruciate Ligament of Knee***

Peyman Dehghanirad<sup>1</sup>,  
Seyed Pejman Nayersabeti<sup>2</sup>,  
Ahmadreza Mirbolook<sup>3</sup>,  
Kamran Asadi<sup>4</sup>,  
Ali Sheykhi<sup>2</sup>,  
Lotfollah Davoodi<sup>5</sup>,  
Bahareh Moaydahmadi<sup>6</sup>,  
Banafsheh Moayedahmadi<sup>7</sup>,  
Mohamadsadegh Mousavi<sup>8</sup>

<sup>1</sup> BSc in Operating Room, Orthopedic Research Center, Rasht Rasool Akram Hospital, Guilan University of Medical Sciences, Rasht, Iran

<sup>2</sup> Orthopedic Surgeon, Rasht Rasool Akram Hospital, Rasht, Iran

<sup>3</sup> Assistant Professor, Department of Orthopedics, Orthopedic Research Center, Faculty of Medicine, Guilan University of Medical Sciences, Rasht, Iran

<sup>4</sup> Associate Professor, Department of Orthopedics, Orthopedic Research Center, Faculty of Medicine, Guilan University of Medical Sciences, Rasht, Iran

<sup>5</sup> Assistant Professor, Department of Infectious Diseases, Antimicrobial Resistance Research Center, Faculty of Medicine, Mazandaran Guilan University of Medical Sciences, Sari, Iran

<sup>6</sup> General Practitioner, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran

<sup>7</sup> BSc in Nursing, Rasht Rasool Akram Hospital, Rasht, Iran

<sup>8</sup> Medical Student, Guilan University of Medical Sciences, Rasht, Iran

(Received November 16, 2015 Accepted, February 4, 2015)

### **Abstract**

**Background and purpose:** Locating and measuring the length of the distal femoral canal is a very important stage in reconstructive surgery of anterior and posterior cruciate ligament rupture in knee. Sometimes it is difficult or impossible to measure it in some patients. To resolve this problem, a measuring tool called the Measuring Instrument of the Length of the Femoral Canal (Satkr) was designed and registered in Iranian patent office. The instrument was designed to measure the length of the femoral canal before creating any canal in distal femur (therefore, enabling surgeons to change it if it was not calculated properly).

**Materials and methods:** In this comparative cross sectional study, a part from Satkr, two other instruments which are commonly used in reconstructive surgery of knee ligaments including a 4.5 graded Reamer and a depth gauge that is the final confirming tool for measuring the length of the canal were applied to 50 patients of both sexes. According to the operating techniques, measures of the length of the canal were separately written and statistical differences were recorded in two-sided way.

**Results:** Data indicated significant differences between the scores of Reimer, depth gauge and Satkr ( $P=0.004$ ).

**Conclusion:** According to this study, Satkr had significantly less errors compared to Reamer. Thus, it can be claimed that the measurements obtained by Satkr are more precise than measurements obtained by other measuring tools.

**Keywords:** Anterior cruciate ligament, posterior cruciate ligament, reconstructive surgery, depth gauge, endobutton

J Mazandaran Univ Med Sci 2015; 25(130): 125-133 (Persian).

## معرفی یک وسیله جدید اندازه گیری طول کanal ران در جراحی های بازسازی رباط های متقطع زانو

پیمان دهقانی راد<sup>۱</sup>

سید پژمان نیرثابتی<sup>۲</sup>

احمدرضا میربلوک<sup>۳</sup>

کامران اسدی<sup>۴</sup>

علی شیخی<sup>۲</sup>

لطف الله داودی<sup>۵</sup>

بهاره موید احمدی<sup>۶</sup>

بنفسه موید احمدی<sup>۷</sup>

محمدصادق موسوی<sup>۸</sup>

### چکیده

**سابقه و هدف:** تعیین محل و اندازه گیری طول کanal در دیستال ران برای جراحی بازسازی پارگی رباط های قدامی و خلفی صلیبی زانو، مرحله ای بسیار مهم در این جراحی می باشد که در بعضی بیماران، به دلایل محاسبه این طول مشکل یا غیرممکن می باشد. برای رفع این مشکل، ابزار اندازه گیری به نام سیستم اندازه گیری طول کanal ران (ساطکر) طراحی و ثبت اختراع شد. هدف از طراحی این وسیله محاسبه طول کanal ران قبل از ایجاد هر کanalی در انتهای استخوان ران می باشد که در صورت مناسب نبودن، می توان مسیر و طول را تغییر داد.

**مواد و روش ها:** در این مطالعه به صورت مقایسه ای - مقطعی از دو ابزار متدال در جراحی بازسازی رباط های زانو (ریمر مدرج ۴/۵ و وسیله عمق سنج)، جهت قیاس با ابزار مورد مطالعه (ساطکر) استفاده شد. ۵۰ بیمار از هر دو جنس مورد بررسی قرار گرفتند. بر اساس تکنیک عمل، طول کanal به طور جداگانه یاداشت و پس از جمع آوری داده ها، اختلاف های آماری به صورت دو طرفه ثبت گردید.

**یافته ها:** داده ها نشان داد که بین نمرات به دست آمده میان ریمر مدرج و عمق سنج و ساطکر اختلاف معنی داری از نظر آماری وجود دارد (p = 0/04).

**استنتاج:** بر اساس نتایج به دست آمده، ساطکر نسبت به ریمر به طور معنی داری خطای کمتری داشته است که می توان بر اساس آن این ادعا را مطرح کرد که نتایج به دست آمده از ساطکر دقیق تر از سایر شیوه های اندازه گیری است.

**واژه های کلیدی:** رباط صلیبی قدامی، رباط صلیبی خلفی، جراحی بازسازی، عمق سنج، اندوباتون

### مقدمه

ساختمان های استخوانی، عناصر خارجی مفصل لیگامانی عضلانی و ساختمان های داخل مفصل می باشد که زانو می باشد. عناصر تشکیل دهنده زانو شامل

از شایع ترین مفاصل بدن که دچار آسیب می شود،

زانو می باشد. عناصر تشکیل دهنده زانو شامل

E-mail: peyman\_rad0@yahoo.com

**مؤلف مسئول:** پیمان دهقانی راد - رشت: بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) تامین اجتماعی، کارشناس اتفاق عمل

۱. کارشناس اتفاق عمل، مرکز تحقیقات ارتوپدی، بیمارستان حضرت رسول اکرم، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران

۲. جراح و متخصص ارتوپدی، بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص)، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران

۳. استادیار، گروه ارتوپدی، مرکز تحقیقات ارتوپدی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران

۴. دانشیار، گروه ارتوپدی، مرکز تحقیقات ارتوپدی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران

۵. استادیار، گروه عفونی، مرکز تحقیقات میکروبیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران

۶. پژوهشک عمومی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران

۷. کارشناس پرستاری، بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص)، رشت، ایران

۸. دانشجوی پژوهشکی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران

تاریخ دریافت: ۱۳۹۳/۸/۲۵ تاریخ ارجاع جهت اصلاحات: ۱۳۹۳/۸/۲۵ تاریخ تصویب: ۱۳۹۳/۱۱/۱۵

فراهم می‌کند. در واقع برداشتن تاندون همسترینگ به حرکت اکستنسور آسیبی وارد نمی‌کند و نسبت به برداشتن تاندون پاتلا درد کمتری دارد(۱۱). استفاده از تاندون‌های همسترینگ که به وسیله‌ی اندوباتن یا کراس‌پین در کanal ران ثابت می‌شوند، دو روش معروف برای Femoral fixation می‌باشند(۶).

حال در روش جراحی Suspension که از اندوباتن استفاده می‌شود، به ابزارهای دقیقی با دقت در حد میلی‌متر نیاز است. بر اساس تکنیک روتین جراحی، در ابتدا باید کanalی را برای قرار دادن تاندون ایجاد نمود. برای ایجاد کanal و تعیین مسیر محل قرارگیری گرافت، باید گاید پینی را در محل رباط صلبی قدامی قبلی پاره شده، در دیستال فمور عبور داد و در صورت مطلوب بودن مسیر، برای گشادر نمودن کanal و عبور اندوباتن، از ریمر کانولیتی ۴/۵ در مسیر گاید پین عبور داده و به محض عبور ریمر از کورتکس دوم که مدرج می‌باشد، عدد روی ریمر را خواند. این عدد نمایانگر طول کanal ران می‌باشد و بر اساس آن جراح تصمیم می‌گیرد که چه طولی از تاندون را درون کanal به وسیله چه سایزی از اندوباتن ثابت نماید(۴-۸). در زمان انجام این اقدامات، مشکلاتی ایجاد می‌شود مانند عبور ناگهانی ریمر از کورتکس انتهای ران و یا عدم توانایی خواندن درست طول کanal توسط ریمر مدرج به دلیل بزرگ بودن کوندیل کناری فمور. در این مورد دوم باید ریمر را خارج نمود و از وسیله‌ای به نام عمق سنج (depth gage) (تصویر شماره ۱) برای اندازه‌گیری طول کanal استفاده نمود. طول کanal دارای حد استانداردی می‌باشد. در مواردی که اندازه‌گیری در این محدوده استاندارد نباشد، باید دوباره گاید پین را وارد و دوباره ریم نمود تا طول مناسب به دست آورده شود. به همین دلیل تصمیم گرفته شد تا وسیله‌ای طراحی شود که بعد از گذاشتن گاید پین و قبل از ریم کردن، بتواند طول کanal ران را اندازه‌گیری کند و یا بدون نیاز به مشاهده با آرتروسکوپی، بتوان طول کanal را به صورت خارج

شامل مینیسک‌ها و لیگامان‌های مقاطع قدامی (ACL) و خلفی (PCL) است(۱). لیگامان‌های مقاطع به عنوان پایدار کننده‌های داخلی زانو و محور حرکات چرخشی زانو محسوب می‌شوند و حرکات رو به عقب و رو به جلو تیبا را بر روی فمور محدود و بر کنترل چرخش و حرکات به لترال تیبا روی فمور کمک می‌کنند(۲).

۱- بازسازی و ترمیم، یکی از درمان‌های معمول و رایج برای پارگی رباط صلبی است. صدمات رباط‌های صلبی معمولاً به وسیله آرتروسکوپی و یا با کمک بافت زنده از یک سوم مرکزی تاندون پاتلا و یا با استفاده از تاندون‌های همسترینگ بازسازی و ترمیم می‌شوند(۳-۵). چندین نوع بازسازی و روش‌های تثبیت وجود دارد که ایجاد کanal در استخوان‌های تیبا و فمور برای قرار دادن گرافت در کanal مربوطه ضروری است. به طور کلی ۳ نوع مکانیسم تثبیت بازسازی رباط صلبی قدامی برای کanal فمور را می‌توان بر اساس میزان تخریب و کاربرد محل، تقسیم بندی کرد که عبارتند از: Suspension, Expansion, Compression به وسیله مداخله با پیچ صورت Compression می‌پذیرد.

۲- Expansion: به روش استفاده از کراس‌پین تعریف می‌گردد.

۳- Suspension: برای این روش که از اندوباتن برای تثبیت تاندون داخل کanal ران استفاده می‌شود، دارای یک قسمت دکمه مانند سوراخ دار به ابعاد ثابت ۱۲\*۴ میلی‌متر و هم‌چنین دارای تسمه‌ای که از سوراخ‌های دکمه به صورت لوب عبور داده شده می‌باشد. از نظر طول تسمه، دارای سایزهای مختلف می‌باشد و بر اساس طول کanal ایجاد شده، سایز مورد نظر انتخاب می‌شود(۱۰،۹).

انتخاب نوع گرافت و روش تثبیت پیوند در جراحی بازسازی رباط صلبی حیاتی و مهم است. بازسازی رباط صلبی به وسیله تاندون همسترینگ قدرت کافی برای توانبخشی و فعالیت زود هنگام را


## مواد و روش ها

این پژوهش به صورت یک مطالعه مقایسه‌ای مقطعي در اتفاق عمل بیمارستان‌های خصوصي و دولتی استان گیلان با توضیح قبلی برای بیمار در مورد نحوه استفاده از اين وسیله انجام گرفته است. معیار ورود به اين مطالعه بیماران دارای اندیکاسیون جراحی زانو به روش آرتروسکوپی بودند. اين اندیکاسیون‌ها عبارت بودند از قفل شدن‌های مکرر زانو، درد زانوی مقاوم به درمان‌های غير جراحی، عدم ثبات در حرکات زانو و پارگی رباط‌های متقطع زانو.


به دلیل این که این ابزار در حالت مطالعات اولیه بوده و تاکنون هیچ مطالعه‌ای در مورد ارزیابی این اختصار انجام نشده است، بنابراین در جلسه پژوهشی و کمیته اخلاق دانشگاه علوم پزشکی گیلان که در تاریخ ۱۳۹۲/۰۵/۰۷ و با شماره ۱۴۱۹۱۶ برگزار شده بود، تصمیم گرفته شد که این وسیله روی ۵۰ نفر از بیماران کاندید جراحی زانو مورد بررسی قرار گیرد.

در این مطالعه بعد از گذاشتن گاید پین، ابتدا قسمت اول ساطکر را از انتهای پین وارد زانو کرده و در محل دو کوندیل درون مفصل ران قرار داده و در ادامه قسمت دوم ساطکر را از نوک پین وارد کرده و بعد از عبور از پوست و عضلات، بر روی کورتکس خروجی پین در بالای زانو قرار داده شد (تصاویر شماره ۱ تا ۵). در بخش فوقانی این دو قسمت، قسمت سوم ساطکر قرار دارد که به صورت خط‌کشی خارج مفصلی طراحی شده و طول کanal ران را نشان می‌دهد (تصویر شماره ۶-۱). اگر طول به دست آمده، در محدوده استاندارد نبود، گاید پین را خارج و مجدداً پین را در مسیری دیگر قرار داده و دوباره با ساطکر، طول را اندازه‌گیری می‌کنیم تا طول مناسب به دست آید و تمامی اعداد به دست آمده یادداشت می‌شود. در ادامه پژوهش، بعد از محاسبه طول کanal با ساطکر، با استفاده از ریم ۴/۵ موجود در ست جراحی، کanal را ایجاد و طول کanal از روی اعداد

مفصلی قبل از هر گونه سوراخ کردن، به دست آورد. بنابراین وسیله‌ای به نام سیستم اندازه‌گیری طول کanal ران (ساطکر) برای بازسازی رباط‌های صلیبی زانو طراحی و ساخته شد (تصویر شماره ۲).

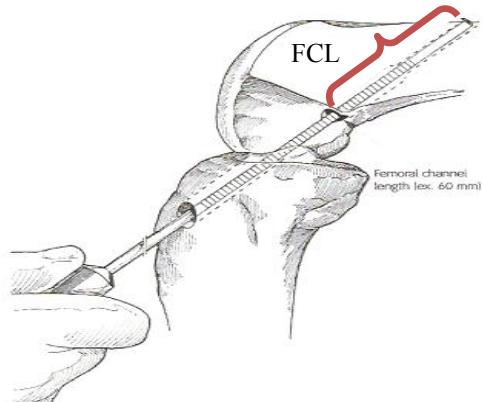

تصویر شماره ۱: وسیله استاندارد طلایی به نام عمق سنج (depth\_gaug)

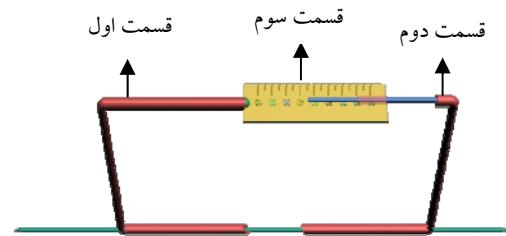

تصویر شماره ۲: سیستم اندازه‌گیری طول کanal ران (ساطکر)


ساطکر در سال ۱۳۹۰ توسط پیمان دهقانی راد (کارشناس عمل‌های بازسازی رباط زانو) طراحی و ساخته شد و پس از اخذ تاییدیه‌های معتبر از انجمن جراحان ارتوپدی ایران، مرکز تحقیقات ارتوپدی و اداره کل تجهیزات پزشکی، در مرکز ثبت اختراقات به ثبت رسید. این وسیله از جنس استیل قابل استریل ساخته شد است. استفاده از این وسیله مانند یک وسیله جراحی خارج مفصلی هیچ گونه عارضه و مشکلی را به دنبال نخواهد داشت. در این مطالعه می‌خواهیم به اعتبار سنجی ساطکر با ریم در زمینه اندازه‌گیری طول کanal ران که در حال حاضر از آن استفاده می‌شود، پردازیم.



تصویر شماره ۵: وارد کردن قسمت دوم ساطکر (آتن شماره ۱)



تصویر شماره ۶: دادن اندازه روی ساطکر (آتن شماره ۱)

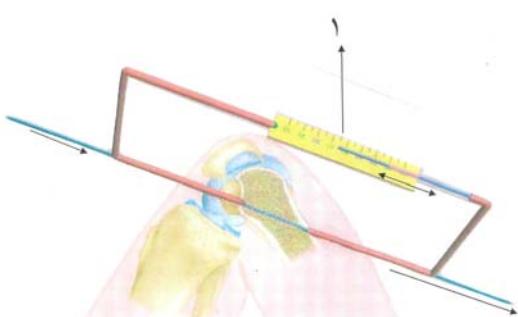

حک شده روی ریمر مشاهده و ثبت گردید. در انتها برای تایید و مقایسه طول به دست آمده از ساطکر و ریمر، از وسیله استاندارد طلایی به نام عمق سنج depth gauge (تصویر شماره ۲) استفاده گردید(۱۳). میزان خطای محاسبه شده در این دو روش نیز نسبت به عمق سنج محاسبه شد. همچنین میانگین طول کاتال ران و سایز ابزار فیکس کننده (اندوباتون) هم ثبت شد. پس از جمع آوری داده‌ها، اطلاعات وارد نرم افزار SPSS v16 شد. جهت تعیین میزان خطای از قدر مطلق میانگین error (Absolute main error) و جهت مقایسه این error ها از آزمون t-test استفاده شد. سطح معنی دار آزمون ها  $p < 0.05$  در نظر گرفته شد و آزمون ها در این مطالعه pilot study به صورت دو طرفه، با اختلاف های آماری ثبت شد.



تصویر شماره ۷: عبور گاید پین از بین دو کوندیل دیستال ران




تصویر شماره ۸: وارد کردن قسمت اول ساطکر

## یافته ها

از ۵۰ بیمار مورد بررسی، ۴۵ بیمار (۹۱ درصد) مرد و ۵ بیمار (۹ درصد) زن بودند. میانگین سنی بیماران مورد مطالعه  $30 \pm 7$  سال بود. هیچ بیماری از مطالعه

اندازه‌گیری دستگاه ریمر با عمق سنج  $0.3 \pm 0.2$  میلی‌متر بود. میانگین خطای اندازه‌گیری ساطکر در مقایسه با ریمر  $0.22 \pm 0.24$  بود. بر اساس نمودار شماره ۱، نمرات به دست آمده میان عمق سنج و ساطکر، اختلاف معنی‌داری از نظر آماری دارند (p=0.004). ساطکر طوری طراحی شده که بتواند فاصله‌های یک میلی‌متری را هم نشان دهد، ولی وسیله عمق سنج فقط می‌تواند مضربی از اعداد دهد. هم‌چنین طبق جداول شماره ۱ و ۲، میان میزان خطای به دست آمده از ساطکر و ریمر، اختلاف آماری معنی‌داری وجود دارد (p=0.007).

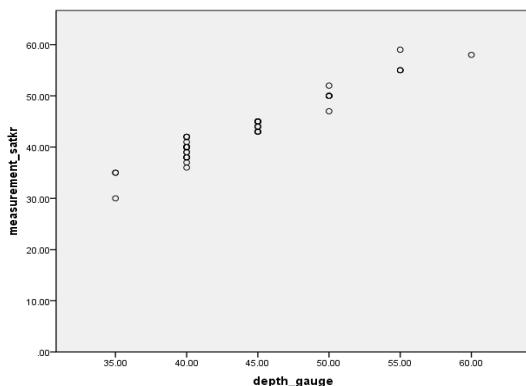

نمودار شماره ۱: مقایسه داده‌های ساطکر با عمق سنج (عمق سنج با دایره پرنگ و ساطکر با مریع)

جدول شماره ۲: داده‌های ثبت شده طول کanal توسط ساطکر

اندازه‌گیری-ساطکر					
اندازه‌ها	طول کanal	تکرار	درصد	درصد معنیر	درصد ابیوه
۲۰	۳۰/۰۰	۱	۲/۰	۲/۰	۲/۰
۴۰	۳۵/۰۰	۲	۴/۰	۴/۰	۴/۰
۶۰	۳۶/۰۰	۱	۲/۰	۲/۰	۲/۰
۸۰	۳۷/۰۰	۱	۲/۰	۲/۰	۲/۰
۱۰۰	۳۷/۰۰	۱	۲/۰	۲/۰	۲/۰
۱۲۰	۳۸/۰۰	۴	۸/۰	۸/۰	۸/۰
۱۴۰	۳۹/۰۰	۲	۴/۰	۴/۰	۴/۰
۱۶۰	۴۰/۰۰	۸	۱۶/۰	۱۶/۰	۱۶/۰
۱۸۰	۴۰/۰۰	۱	۲/۰	۲/۰	۲/۰
۲۰۰	۴۱/۰۰	۱	۲/۰	۲/۰	۲/۰
۲۲۰	۴۲/۰۰	۳	۶/۰	۶/۰	۶/۰
۲۴۰	۴۳/۰۰	۵	۱۰/۰	۱۰/۰	۱۰/۰
۲۶۰	۴۴/۰۰	۲	۴/۰	۴/۰	۴/۰
۲۸۰	۴۴/۰۰	۸	۱۶/۰	۱۶/۰	۱۶/۰
۳۰۰	۴۵/۰۰	۱	۲/۰	۲/۰	۲/۰
۳۲۰	۴۵/۰۰	۱	۲/۰	۲/۰	۲/۰
۳۴۰	۴۶/۰۰	۲	۴/۰	۴/۰	۴/۰
۳۶۰	۴۷/۰۰	۱	۲/۰	۲/۰	۲/۰
۳۸۰	۴۷/۰۰	۱	۲/۰	۲/۰	۲/۰
۴۰۰	۴۸/۰۰	۱	۲/۰	۲/۰	۲/۰
۴۲۰	۴۸/۰۰	۱	۲/۰	۲/۰	۲/۰
۴۴۰	۴۹/۰۰	۱	۲/۰	۲/۰	۲/۰
۴۶۰	۵۰/۰۰	۱	۲/۰	۲/۰	۲/۰
۴۸۰	۵۱/۰۰	۱	۲/۰	۲/۰	۲/۰
۵۰۰	۵۲/۰۰	۱	۲/۰	۲/۰	۲/۰
۵۲۰	۵۳/۰۰	۱	۲/۰	۲/۰	۲/۰
۵۴۰	۵۴/۰۰	۱	۲/۰	۲/۰	۲/۰
۵۶۰	۵۵/۰۰	۱	۲/۰	۲/۰	۲/۰
۵۸۰	۵۶/۰۰	۱	۲/۰	۲/۰	۲/۰
۶۰۰	۵۷/۰۰	۱	۲/۰	۲/۰	۲/۰
۶۲۰	۵۸/۰۰	۱	۲/۰	۲/۰	۲/۰
۶۴۰	۵۹/۰۰	۱	۲/۰	۲/۰	۲/۰
۶۶۰	۶۰/۰۰	۱	۲/۰	۲/۰	۲/۰
۶۸۰	۶۱/۰۰	۱	۲/۰	۲/۰	۲/۰
۷۰۰	۶۲/۰۰	۱	۲/۰	۲/۰	۲/۰
۷۲۰	۶۳/۰۰	۱	۲/۰	۲/۰	۲/۰
۷۴۰	۶۴/۰۰	۱	۲/۰	۲/۰	۲/۰
۷۶۰	۶۵/۰۰	۱	۲/۰	۲/۰	۲/۰
۷۸۰	۶۶/۰۰	۱	۲/۰	۲/۰	۲/۰
۸۰۰	۶۷/۰۰	۱	۲/۰	۲/۰	۲/۰
۸۲۰	۶۸/۰۰	۱	۲/۰	۲/۰	۲/۰
۸۴۰	۶۹/۰۰	۱	۲/۰	۲/۰	۲/۰
۸۶۰	۷۰/۰۰	۱	۲/۰	۲/۰	۲/۰
۸۸۰	۷۱/۰۰	۱	۲/۰	۲/۰	۲/۰
۹۰۰	۷۲/۰۰	۱	۲/۰	۲/۰	۲/۰
۹۲۰	۷۳/۰۰	۱	۲/۰	۲/۰	۲/۰
۹۴۰	۷۴/۰۰	۱	۲/۰	۲/۰	۲/۰
۹۶۰	۷۵/۰۰	۱	۲/۰	۲/۰	۲/۰
۹۸۰	۷۶/۰۰	۱	۲/۰	۲/۰	۲/۰
۱۰۰۰	۷۷/۰۰	۱	۲/۰	۲/۰	۲/۰
۱۰۲۰	۷۸/۰۰	۱	۲/۰	۲/۰	۲/۰
۱۰۴۰	۷۹/۰۰	۱	۲/۰	۲/۰	۲/۰
۱۰۶۰	۸۰/۰۰	۱	۲/۰	۲/۰	۲/۰
۱۰۸۰	۸۱/۰۰	۱	۲/۰	۲/۰	۲/۰
۱۱۰۰	۸۲/۰۰	۱	۲/۰	۲/۰	۲/۰
۱۱۲۰	۸۳/۰۰	۱	۲/۰	۲/۰	۲/۰
۱۱۴۰	۸۴/۰۰	۱	۲/۰	۲/۰	۲/۰
۱۱۶۰	۸۵/۰۰	۱	۲/۰	۲/۰	۲/۰
۱۱۸۰	۸۶/۰۰	۱	۲/۰	۲/۰	۲/۰
۱۲۰۰	۸۷/۰۰	۱	۲/۰	۲/۰	۲/۰
۱۲۲۰	۸۸/۰۰	۱	۲/۰	۲/۰	۲/۰
۱۲۴۰	۸۹/۰۰	۱	۲/۰	۲/۰	۲/۰
۱۲۶۰	۹۰/۰۰	۱	۲/۰	۲/۰	۲/۰
۱۲۸۰	۹۱/۰۰	۱	۲/۰	۲/۰	۲/۰
۱۳۰۰	۹۲/۰۰	۱	۲/۰	۲/۰	۲/۰
۱۳۲۰	۹۳/۰۰	۱	۲/۰	۲/۰	۲/۰
۱۳۴۰	۹۴/۰۰	۱	۲/۰	۲/۰	۲/۰
۱۳۶۰	۹۵/۰۰	۱	۲/۰	۲/۰	۲/۰
۱۳۸۰	۹۶/۰۰	۱	۲/۰	۲/۰	۲/۰
۱۴۰۰	۹۷/۰۰	۱	۲/۰	۲/۰	۲/۰
۱۴۲۰	۹۸/۰۰	۱	۲/۰	۲/۰	۲/۰
۱۴۴۰	۹۹/۰۰	۱	۲/۰	۲/۰	۲/۰
۱۴۶۰	۱۰۰/۰۰	۱	۲/۰	۲/۰	۲/۰
۱۴۸۰	۱۰۱/۰۰	۱	۲/۰	۲/۰	۲/۰
۱۵۰۰	۱۰۲/۰۰	۱	۲/۰	۲/۰	۲/۰
۱۵۲۰	۱۰۳/۰۰	۱	۲/۰	۲/۰	۲/۰
۱۵۴۰	۱۰۴/۰۰	۱	۲/۰	۲/۰	۲/۰
۱۵۶۰	۱۰۵/۰۰	۱	۲/۰	۲/۰	۲/۰
۱۵۸۰	۱۰۶/۰۰	۱	۲/۰	۲/۰	۲/۰
۱۶۰۰	۱۰۷/۰۰	۱	۲/۰	۲/۰	۲/۰
۱۶۲۰	۱۰۸/۰۰	۱	۲/۰	۲/۰	۲/۰
۱۶۴۰	۱۰۹/۰۰	۱	۲/۰	۲/۰	۲/۰
۱۶۶۰	۱۱۰/۰۰	۱	۲/۰	۲/۰	۲/۰
۱۶۸۰	۱۱۱/۰۰	۱	۲/۰	۲/۰	۲/۰
۱۷۰۰	۱۱۲/۰۰	۱	۲/۰	۲/۰	۲/۰
۱۷۲۰	۱۱۳/۰۰	۱	۲/۰	۲/۰	۲/۰
۱۷۴۰	۱۱۴/۰۰	۱	۲/۰	۲/۰	۲/۰
۱۷۶۰	۱۱۵/۰۰	۱	۲/۰	۲/۰	۲/۰
۱۷۸۰	۱۱۶/۰۰	۱	۲/۰	۲/۰	۲/۰
۱۸۰۰	۱۱۷/۰۰	۱	۲/۰	۲/۰	۲/۰
۱۸۲۰	۱۱۸/۰۰	۱	۲/۰	۲/۰	۲/۰
۱۸۴۰	۱۱۹/۰۰	۱	۲/۰	۲/۰	۲/۰
۱۸۶۰	۱۲۰/۰۰	۱	۲/۰	۲/۰	۲/۰
۱۸۸۰	۱۲۱/۰۰	۱	۲/۰	۲/۰	۲/۰
۱۹۰۰	۱۲۲/۰۰	۱	۲/۰	۲/۰	۲/۰
۱۹۲۰	۱۲۳/۰۰	۱	۲/۰	۲/۰	۲/۰
۱۹۴۰	۱۲۴/۰۰	۱	۲/۰	۲/۰	۲/۰
۱۹۶۰	۱۲۵/۰۰	۱	۲/۰	۲/۰	۲/۰
۱۹۸۰	۱۲۶/۰۰	۱	۲/۰	۲/۰	۲/۰
۲۰۰۰	۱۲۷/۰۰	۱	۲/۰	۲/۰	۲/۰
۲۰۲۰	۱۲۸/۰۰	۱	۲/۰	۲/۰	۲/۰
۲۰۴۰	۱۲۹/۰۰	۱	۲/۰	۲/۰	۲/۰
۲۰۶۰	۱۳۰/۰۰	۱	۲/۰	۲/۰	۲/۰
۲۰۸۰	۱۳۱/۰۰	۱	۲/۰	۲/۰	۲/۰
۲۱۰۰	۱۳۲/۰۰	۱	۲/۰	۲/۰	۲/۰
۲۱۲۰	۱۳۳/۰۰	۱	۲/۰	۲/۰	۲/۰
۲۱۴۰	۱۳۴/۰۰	۱	۲/۰	۲/۰	۲/۰
۲۱۶۰	۱۳۵/۰۰	۱	۲/۰	۲/۰	۲/۰
۲۱۸۰	۱۳۶/۰۰	۱	۲/۰	۲/۰	۲/۰
۲۲۰۰	۱۳۷/۰۰	۱	۲/۰	۲/۰	۲/۰
۲۲۲۰	۱۳۸/۰۰	۱	۲/۰	۲/۰	۲/۰
۲۲۴۰	۱۳۹/۰۰	۱	۲/۰	۲/۰	۲/۰
۲۲۶۰	۱۴۰/۰۰	۱	۲/۰	۲/۰	۲/۰
۲۲۸۰	۱۴۱/۰۰	۱	۲/۰	۲/۰	۲/۰
۲۳۰۰	۱۴۲/۰۰	۱	۲/۰	۲/۰	۲/۰
۲۳۲۰	۱۴۳/۰۰	۱	۲/۰	۲/۰	۲/۰
۲۳۴۰	۱۴۴/۰۰	۱	۲/۰	۲/۰	۲/۰
۲۳۶۰	۱۴۵/۰۰	۱	۲/۰	۲/۰	۲/۰
۲۳۸۰	۱۴۶/۰۰	۱	۲/۰	۲/۰	۲/۰
۲۴۰۰	۱۴۷/۰۰	۱	۲/۰	۲/۰	۲/۰
۲۴۲۰	۱۴۸/۰۰	۱	۲/۰	۲/۰	۲/۰
۲۴۴۰	۱۴۹/۰۰	۱	۲/۰	۲/۰	۲/۰
۲۴۶۰	۱۵۰/۰۰	۱	۲/۰	۲/۰	۲/۰
۲۴۸۰	۱۵۱/۰۰	۱	۲/۰	۲/۰	۲/۰
۲۵۰۰	۱۵۲/۰۰	۱	۲/۰	۲/۰	۲/۰
۲۵۲۰	۱۵۳/۰۰	۱	۲/۰	۲/۰	۲/۰
۲۵۴۰	۱۵۴/۰۰	۱	۲/۰	۲/۰	۲/۰
۲۵۶۰	۱۵۵/۰۰	۱	۲/۰	۲/۰	۲/۰
۲۵۸۰	۱۵۶/۰۰	۱	۲/۰	۲/۰	۲/۰
۲۶۰۰	۱۵۷/۰۰	۱	۲/۰	۲/۰	۲/۰
۲۶۲۰	۱۵۸/۰۰	۱	۲/۰	۲/۰	۲/۰
۲۶۴۰	۱۵۹/۰۰	۱	۲/۰	۲/۰	۲/۰
۲۶۶۰	۱۶۰/۰۰	۱	۲/۰	۲/۰	۲/۰
۲۶۸۰	۱۶۱/۰۰	۱	۲/۰	۲/۰	۲/۰
۲۷۰۰	۱۶۲/۰۰	۱	۲/۰	۲/۰	۲/۰
۲۷۲۰	۱۶۳/۰۰	۱	۲/۰	۲/۰	۲/۰
۲۷۴۰	۱۶۴/۰۰	۱	۲/۰	۲/۰	۲/۰
۲۷۶۰	۱۶۵/۰۰	۱	۲/۰	۲/۰	۲/۰
۲۷۸۰	۱۶۶/۰۰	۱	۲/۰	۲/۰	۲/۰
۲۸۰۰	۱۶۷/۰۰	۱	۲/۰	۲/۰	۲/۰
۲۸۲۰	۱۶۸/۰۰	۱	۲/۰	۲/۰	۲/۰
۲۸۴۰	۱۶۹/۰۰	۱	۲/۰	۲/۰	۲/۰
۲۸۶۰	۱۷۰/۰۰	۱	۲/۰	۲/۰	۲/۰
۲۸۸۰	۱۷۱/۰۰	۱	۲/۰	۲/۰	۲/۰
۲۹۰۰	۱۷۲/۰۰	۱	۲/۰	۲/۰	۲/۰
۲۹۲۰	۱۷۳/۰۰	۱	۲/۰	۲/۰	۲/۰
۲۹۴۰	۱۷۴/۰۰	۱	۲/۰	۲/۰	۲/۰
۲۹۶۰	۱۷۵/۰۰	۱	۲/۰	۲/۰	۲/۰
۲۹۸۰	۱۷۶/۰۰	۱			

کوندیل کناری، عدد دقیق روی عمق سنج قابل خواندن نبود) و با طول کانال به دست آورده توسط ریمر و ساطکر مورد مقایسه قرار گرفت.

در پایان می‌توان نتیجه گیری کرد که بر اساس مطالعه حاضر، دقت ساطکر نسبت به ریمر و وسیله عمقدسنج بیشتر می‌باشد و اعداد حاصل از ساطکر دقیق‌تر از ریمر است. از سوی دیگر به دلیل عبور کردن ناگهانی ریمر از دومین کورتکس انتهای ران در حین چرخش دریل، در بعضی مواقع عدد روی ریمر را نمی‌توان با دقت خواند. هم‌چنین اعداد به دست آمده از ساطکر و وسیله عمقدسنج (استاندارد طلایی) به هم نزدیک بود. کاربرد دیگر استفاده از ساطکر به این نحو می‌باشد که در مرحله قبل از ریم کردن، طول کانال انتهای ران را می‌توان اندازه گیری کرد، که این اندازه گیری، خارج از مفصل زانو انجام شده و قابل تجدید نظر می‌باشد. زیرا در ابتدای مرحله قبل از پین گذاری، می‌توان طول کانال ران را بر اساس دلخواه به دست آورده و مسیری را انتخاب کرد که بهترین طول را با زاویه‌ای که بهترین طول را در بر دارد ایجاد نماید.

ساطکر برای کلیه روش‌های بازسازی رباط‌های زانوی قدامی و خلفی قابل استفاده می‌باشد و در واقع یک وسیله تسهیل کننده در روند ادامه جراحی می‌باشد. البته این نکته نیز قابل ذکر است که اعداد قابل مشاهده از وسیله عمقدسنج depth-gauge می‌باشد (که آن هم بعد از مدتی به دلیل استریل کردن‌های مداوم، اعداد حک شده روی وسیله کم رنگ گشته و قابل خواندن نیست)، ولی با استفاده از ساطکر، اعداد به دست آمده از آن دارای واحد ۵ میلی‌متری می‌باشد که آن هم بعد از مدتی به دلیل می‌گردد که با برش کوندیل کناری ران، به طور دقیق می‌توان اندازه‌های روی عمق سنج را مشاهده نمود و اگر تروکار ورودی لنز آرتروسکوپی در جای مناسبی قرار نگیرد، خواندن اعداد روی عمق سنج به مراتب سخت تر خواهد شد. بعد از ایجاد کانال با استفاده از ریمر ۴/۵،

جدول شماره ۳: داده‌های ثبت شده داده‌ها توسط اندازه گیر عمق سنج

اندازه‌ها	طول کانال	تکرار	عمقدسنج		
			درصد معین	درصد	درصد انبوه
۴۰	۶/۰	۳	۳۵/۰۰	۳۵/۰۰	۴۰/۰۰
۴۴/۰	۳۸/۰	۱۹	۴۰/۰۰	۴۰/۰۰	۴۰/۰۰
۷۶/۰	۳۰/۰	۱۵	۴۵/۰۰	۴۵/۰۰	۴۵/۰۰
۹۰/۰	۱۶/۰	۸	۵۰/۰۰	۵۰/۰۰	۵۰/۰۰
۹۸/۰	۸/۰	۴	۵۵/۰۰	۵۵/۰۰	۵۵/۰۰
۱۰۰/۰	۷/۰	۱	۶۰/۰۰	۶۰/۰۰	۶۰/۰۰
	۱۰۰/۰	۵۰	جمع کل		

## بحث

در این مطالعه که جراحی بازسازی رباط‌های زانو توسط آرتروسکوپی و با استفاده از وسیله فیکس کننده تاندون (اندوباتون) در کانال ران انجام شده بود، در همه ۵۰ بیمار توانستیم طول کانال ران را قبل از ریم کردن، توسط ساطکر اندازه گیری کنیم و در ادامه که از ریم استفاده شد، در ۱۸ مورد از ۵۰ مورد، طول کانال با دقت قابل اندازه گیری نبود و در سایر موارد هم اعداد خوانده شده، مضربی از عدد پنج بود. در این مطالعه به دلیل همراهی ریمر با ساطکر، بعد از گذاشتن گاید پین، طول کانال قبل از ریم کردن توسط ساطکر اندازه گیری و در اندازه طول کانال تجدید نظر صورت گرفت و پس از آن ریم کردن ادامه یافت که این خود یکی از مزایای بارز ساطکر بود. به طور مثال در بیمار شماره ۳۳ (یکی از ۱۰ موردی که در طول کانال تجدید نظر صورت گرفت) طول به دست آمده قبل از ریم کردن با استفاده از ساطکر، ۲۷ میلی‌متر بود که این طول برای ادامه عمل جراحی مطلوب نبود. با وارد کردن مجدد گاید پین، مسیر کانال قبل از ریم کردن، طویل‌تر شد (۴۰ میلی‌متر). در صورتی که اگر طبق روش‌های روتین، ریم کردن انجام می‌گرفت، ابتدا کانال ۲۷ میلی‌متری ایجاد می‌شد و به ترتیب مجدد گاید پین و ریم کردن صورت می‌گرفت تا بالاخره طول کانال مناسبی به دست می‌آمد. در این مطالعه هم‌چنین از عمق سنج (استاندارد طلایی) استفاده شد که طول دقیق کانال را بعد از ریم کردن تایید می‌گردید (در بعضی از موارد به دلیل بزرگی

جراجان متخصص ارتوپد استان گیلان که همکاری لازم در استفاده از این وسیله و تکمیل طرح و مدیریت درمان سازمان تامین اجتماعی و تمامی پرسنل اتاق عمل و بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) تامین اجتماعی رشت و مهندسین پارک علم و فناوری استان گیلان بابت مشاوره و بنیاد نخبگان استان گیلان و همچنین از آقای مهندس بهروز تقایی و پرسنل فی تراشکاری بهفر که در ساخت ساطکر ما را یاری نمودند، تشکر می‌نماییم.

اگر طول کanal مناسب نبود، تجدید نظر در ایجاد کanal جدید به دلیل محدود بودن فضا، سخت‌تر می‌گردد.

## سپاسگزاری

از معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گیلان و ریاست محترم مرکز تحقیقات ارتوپدی، بابت تامین بخشی از اعتبارات مالی انجام طرح، دکتر کاظم نژاد بابت مشاوره آمار، پزشکان و

## References

1. Rezaei Y, Mirmohamad SM, Vaziri K, Fakhrejahani F, Rahimnia A. Sensitivity and specificity of MRI and Arthroscopy in knee Joint injuries. Tehran University Medical Journal 2007; 65(9): 47-52.
2. Rockwood ChA. Rockwood and Green's Fractures in Adults. 6<sup>th</sup> ed. Philadelphia, Lippincott Williams & Wilkins; 2006.
3. Kirkley A, Litchfield R, Thain L, Spouge A. Agreement between magnetic resonance imaging and arthroscopic evaluation of the shoulder joint in primary anterior dislocation of the shoulder. Clin J Sport Med 2003; 13(3): 148-151.
4. Bergfeld J, Glaser V, Lloyd M. Pinpointing the cause of acute knee pain. Patient Care 1997; 31(18): 100-117.
5. Calmbach WL, Hutchens M. Evaluation of patients presenting with knee pain: Part I. History, physical examination, radiographs, and laboratory tests. Am Fam Physician 2003; 68(5): 907-912.
6. Buoncristiani AM, Tjoumakaris FP, Starman JS, Ferretti F, Fu FH. Anatomic double-bundle anterior cruciate ligament reconstruction. Arthroscopy 2006; 22(9): 1000-1006.
7. Caborn DN, Chang HC. Single femoral socket double-bundle anterior cruciate ligament reconstruction using tibialis anterior tendon: description of a new technique. Arthroscopy 2005; 21(10): 1273.
8. Muneta T, Sekiya I, Ogiuchi T, Yagishita K, Yamamoto H, Shinomiya K. Effects of aggressive early rehabilitation on the outcome of anterior cruciate ligament reconstruction with multi-strand semitendinosus tendon. Int Orthop 1998; 22(6): 352-356.
9. Muneta T, Sekiya I, Yagishita K, Ogiuchi T, Yamamoto H, Shinomiya K. Two-bundle Reconstruction of the Anterior Cruciate Ligament Using Semitendinosus Tendon with EndoButton: Operative Technique and Preliminary Results. Arthroscopy 1999; 15(6): 618-624.
10. Ng W H, Griffith JF, Hung EHY, Paunipagar B, Law BKY, Yung PH. Imaging of the anterior cruciate ligament. World J Orthop 2011; 2(8): 75-84.
11. Radford WJ, Amis AA. Biomechanics of a double Prosthetic ligament in the anterior cruciate ligament. JBJS Br 1990; 72(6): 1038-1043.
12. Rosenberg TD, Graft B. Techniques for ACL Reconstruction with Multi-Trac Drill Guide, Mansfield, MA: Acufex Microsurgical Inc. 1994.

13. Dargel J, Gotter M, Mader K, Pennig D, Koebke J, Schmidt-Wiethoff R. Biomechanics of the anterior cruciate ligament and implications for surgical reconstruction. *Strategies Trauma Limb Reconstr* 2007; 2(1):1-12.
14. Pastrone A, Ferro A, Bruzzone M, Bonasia DE, Pellegrino P, D'Elicio D. Anterior cruciate ligament reconstruction creating the femoral tunnel through the anteromedial portal. Surgical technique. *Curr Rev Musculoskelet Med* 2011; 4(2): 52-56.
15. Inventors JL, Spenciner D. Acl reconstruction tunnel gauge and method Publication number: US20120330323 A1 Filing date: Jun 24, 2011 Application number: US 13/168,104.
16. Frank CB, Jackson DW. The science of reconstructionof the anterior cruciate ligament. *J Bone Joint Surg Am* 1997; 79(10): 1556-1576
17. Miyasaka KC, Daniel DM, Stone ML, Hirshman P. The incidence of knee ligament injuries in the general population. *Am J Knee Surg* 1991; 4(1): 3-8.